
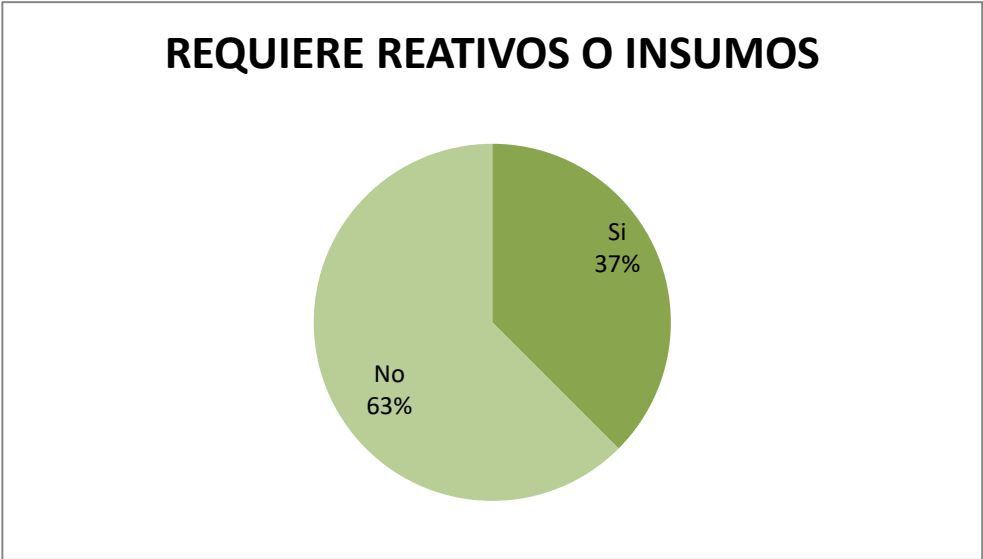
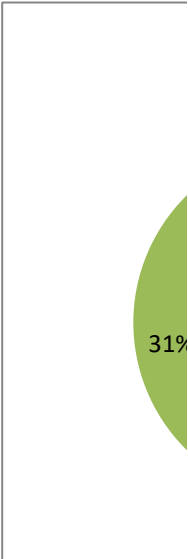


N°	REFERENCIA	EQUIPO	MANUAL		TIPO DE ENERGIA		
			Si	No	Electrica	Baterias	Manual
1		Micro Pipeteadora		1			1
2		Pipeteador		1			1
3	10061138	TSP		1	1		
4	10061137	TSP		1	1		
5	10061139	Hi-Vol PM10		1	1		
6	10067078	Celda solar		1	1		
7	10064390	Dendrometro	1			1	
8	10064392	Infiltrometro		1			1
9	10064388	Estación meteorologica Antage Pro 2 Plus		1		1	
10	10064390	Hipsometro		1			1
11	10064389	Muestreo Isosinetico		1	1		
12	10061136	Rac de Gases		1	1		
13	10061135	Rac de Gases		1	1		
14	10061134	Micromolinete		1		1	
15	10061133	Micromolinete		1		1	
16	10061027	Estación meteorologica Water Satation		1		1	
17	10061499	Sonmetros		1	1	1	
18	10061017	Sonmetros		1	1	1	
19	10067088	Espectofotometro	1		1		
20	10049148	Multiparametro		1		1	
21	10049151	Camara de conteo colonias	1		1		
22	10049163	Plancha de agitación y calentamiento	1		1		
23	10013571	Turbidimetro		1	1		
24	10049146	Cabina de flujo laminar		1	1		
25	10064391	Compactador de Suelo		1		1	
27	10049147	Autoclave Matachana		1	1		
28	10007410	Autoclave		1	1		
29	10007970	Equipo de Energia Alternativas		1	1		
30	10067078	Panel Solar		1	1		
31	10007449	Minilaboratorio Electrónico para Análisis de Suelos		1		1	
32	10007450	Minilaboratorio Electrónico para Análisis de Suelos		1		1	
33	10007448	Minilaboratorio Electrónico para Análisis de Suelos		1		1	
34	10067082	Digestor anaerobio		1	1		
35		PH metro		1	1		
36	10007491	Incubadora		1	1		
37	10049152	Incubadora		1	1		


38	10049162	Horno		1	1		
39	10049161	Camara de anaerobiosis		1			1
40	10007448	Medidor de Temperatura		1		1	
41	10007423	Centrifuga		1	1		
41	Total		4	36	24	13	5
		%	10	88	59	32	12

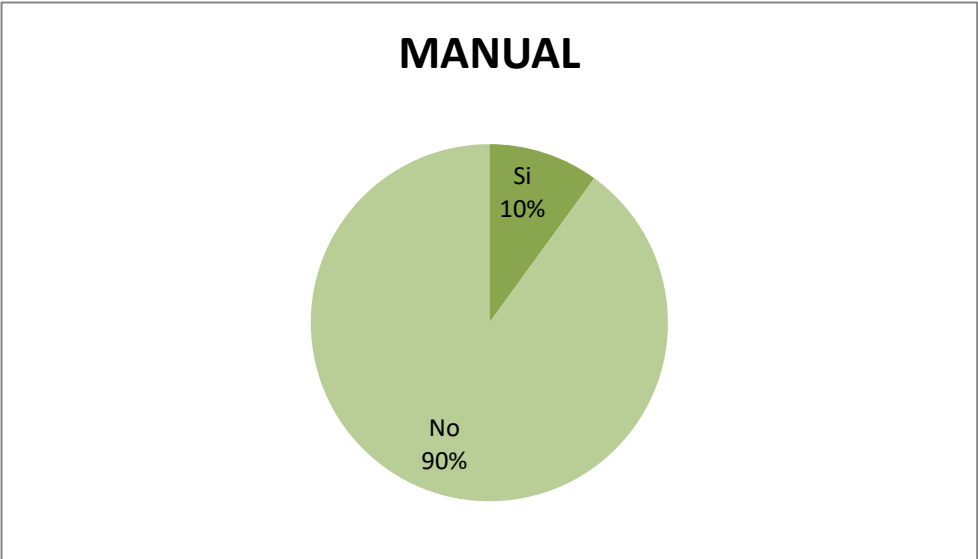

Mar

CALIBRACIÓN	Nunca	1
	Hace 1 año	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Hace 6 meses	
	Nunca	1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Hace 1 año	
	Hace 6 meses	
COMPLETOS	Nunca	
	Hace 1 año	
REQUIERE REATIVOS O INSUMOS	Hace 6 meses	
	Nunca	1

	1					1			1			1
	1			1					1			1
	1					1			1			1
	1			1					1			1
15	25	0	15	9	0	32	0	0	40	0	0	40
37	61	0	100	22	0	78	0	0	98	0	0	98

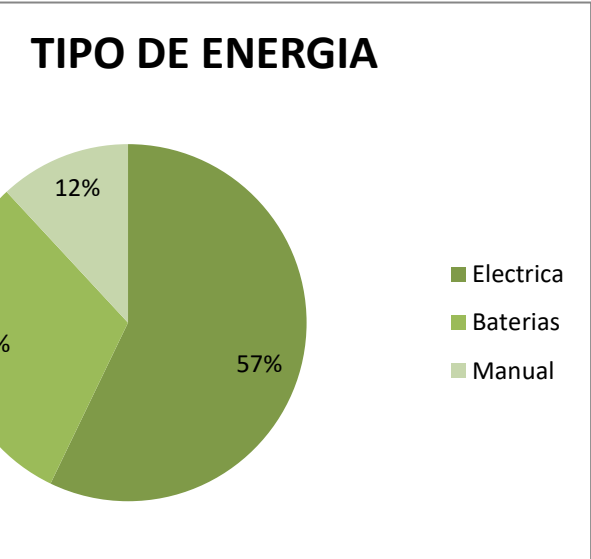

OSERVACIONES

hace falta el Pistofono

hace falta el Pistofono

Hay quimicos pero no los acordes con el equipo

Calibradores y las membranas estan dañadas

Calibradores

Reactivos incompletos
